



Flödesschema beställning, anpassning och validering

- Detta dokument beskriver beställningsprocessen samt ev. anpassning och validering av IT och MT utrustning i form av flödesschema
- Form för länk till aktiveter i cut-over appen
- Form för länk till stöddokument



Dator, skärm, diktafon, dokumentskanner

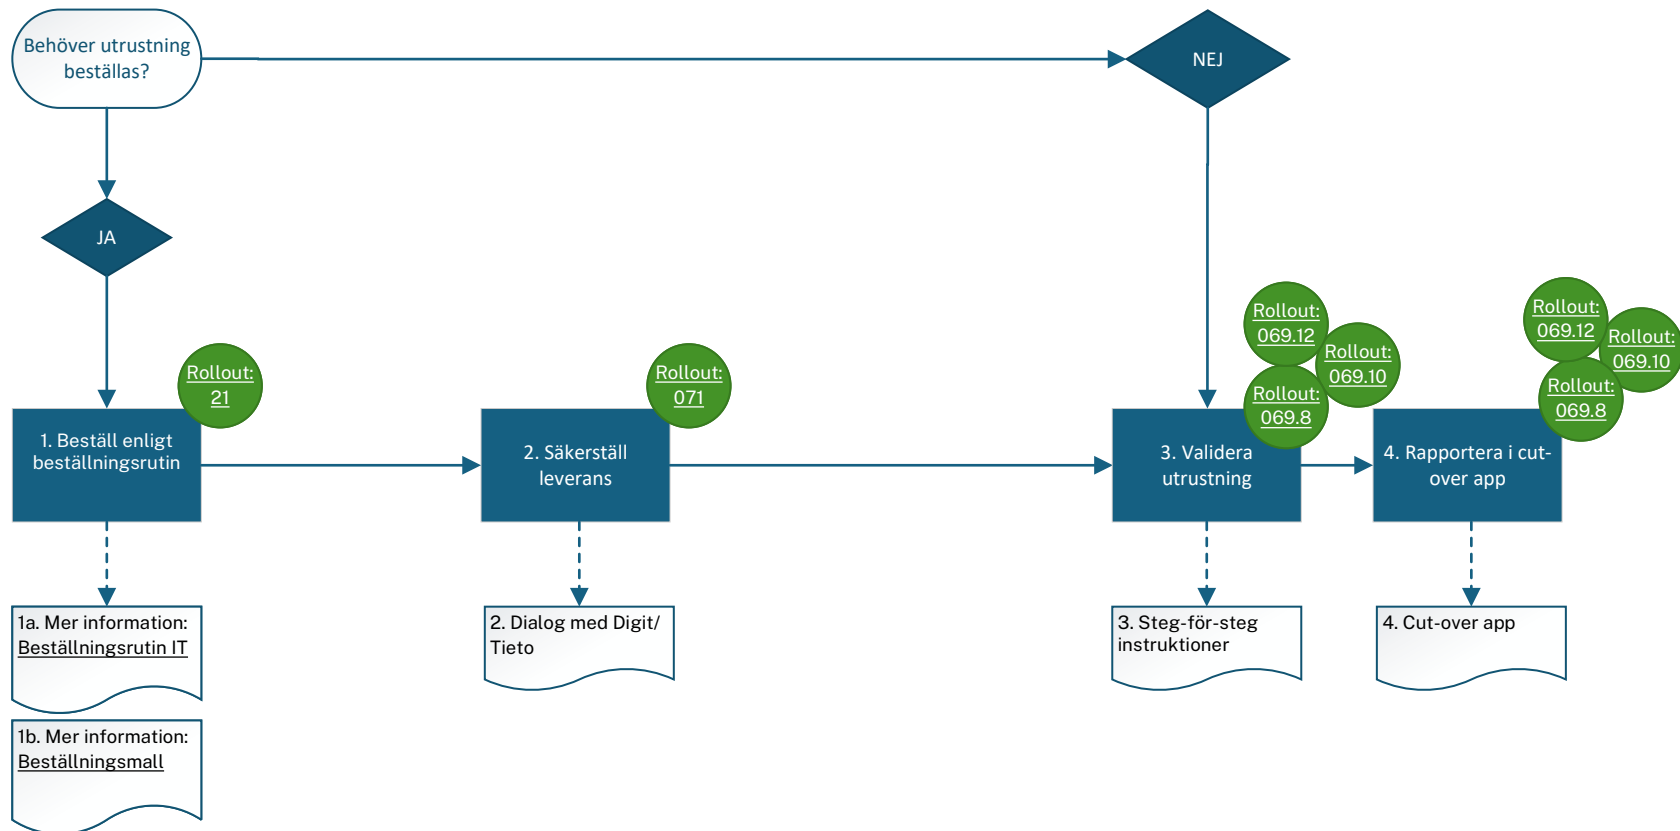


-6 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

Handskanner

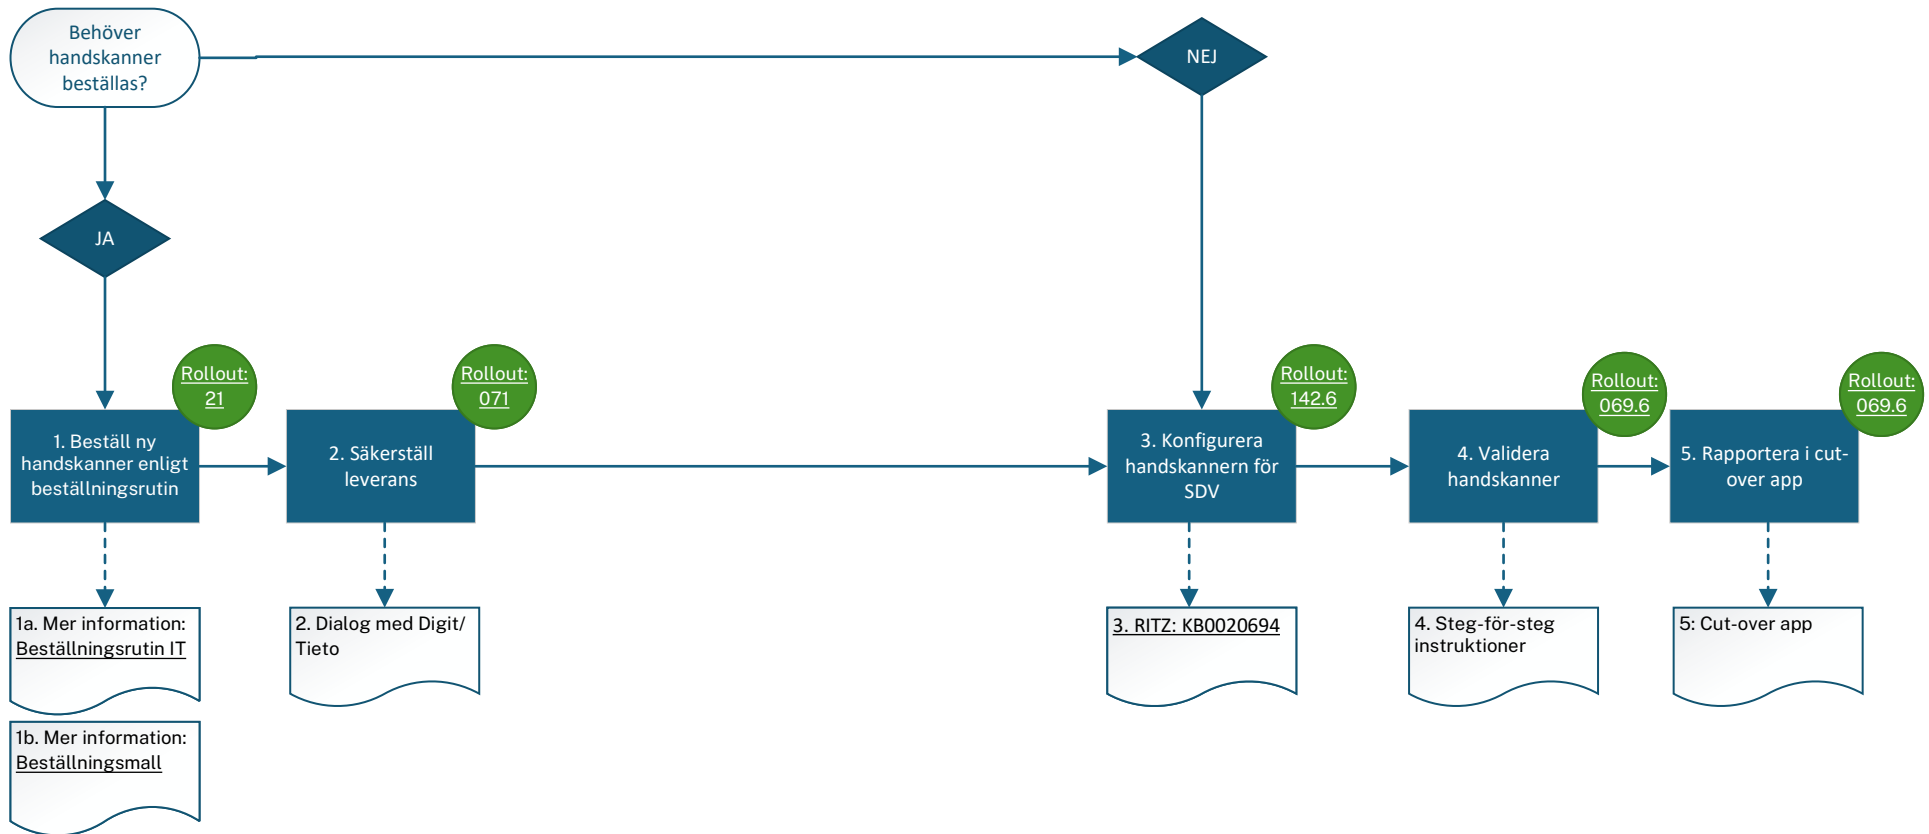


-6 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

Etikettskrivare

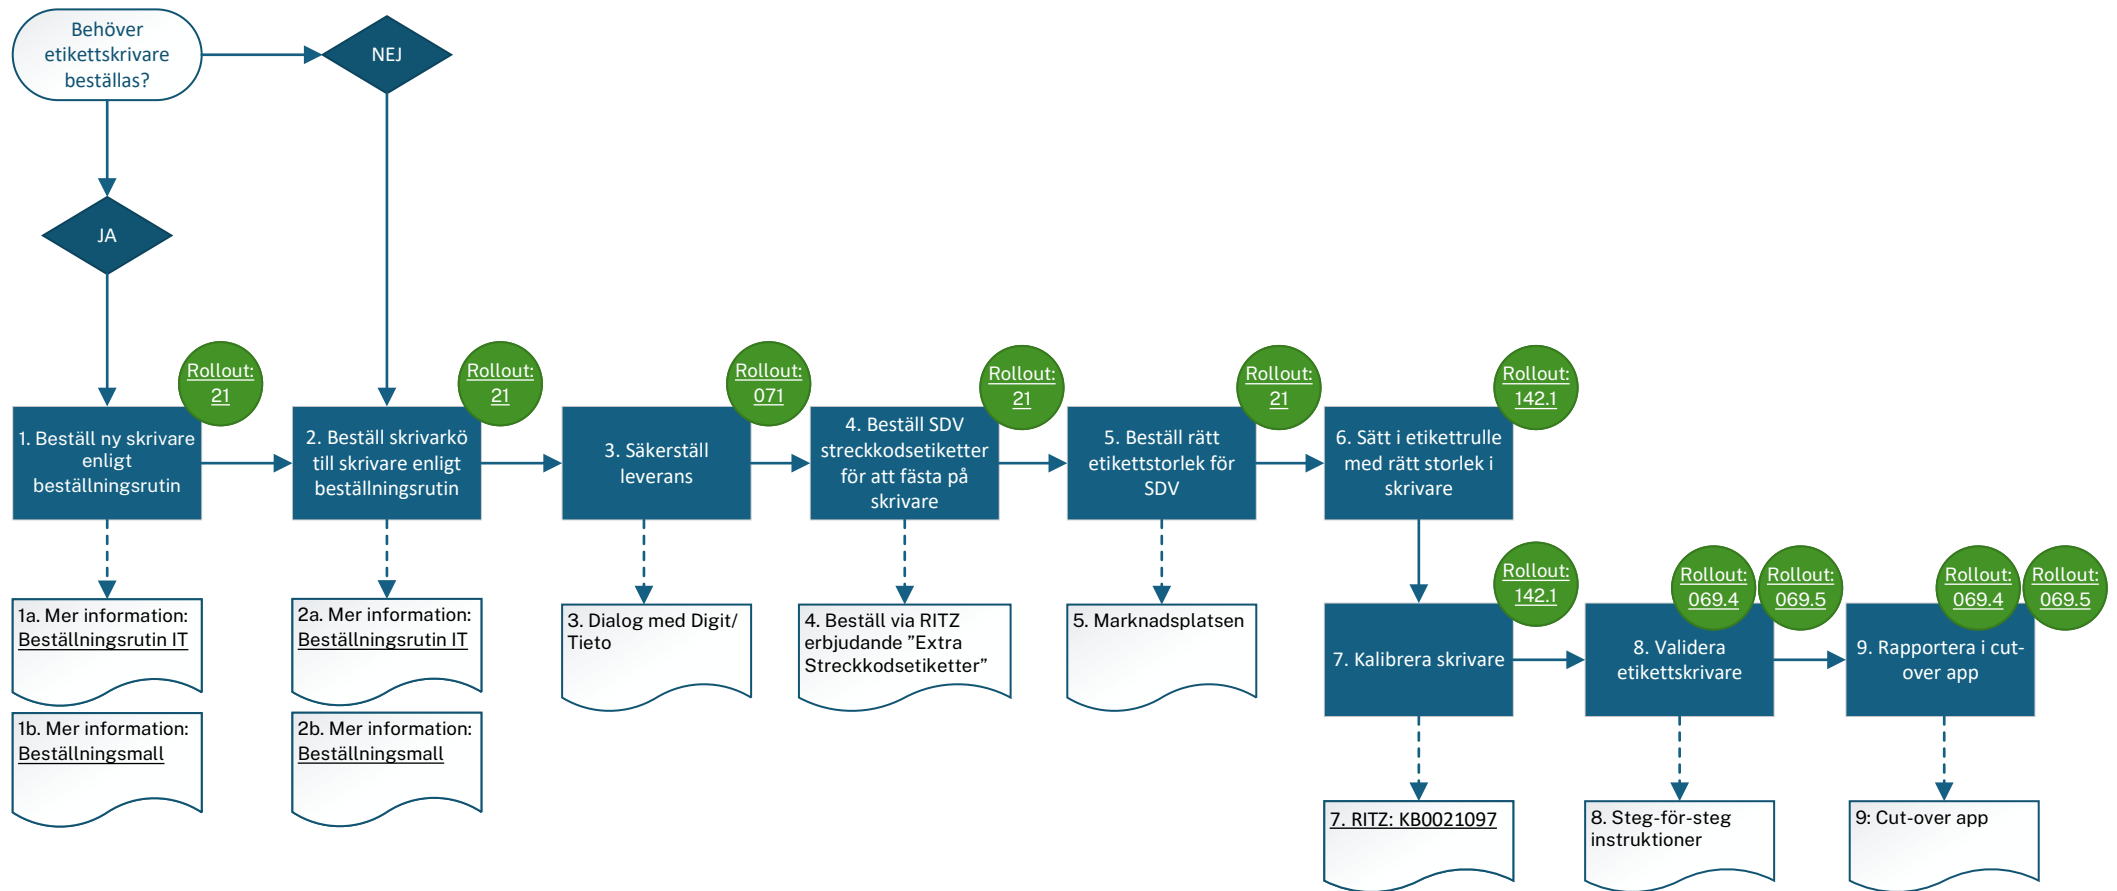

-6 månader


-5 veckor

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

Patientarmbandsskrivare

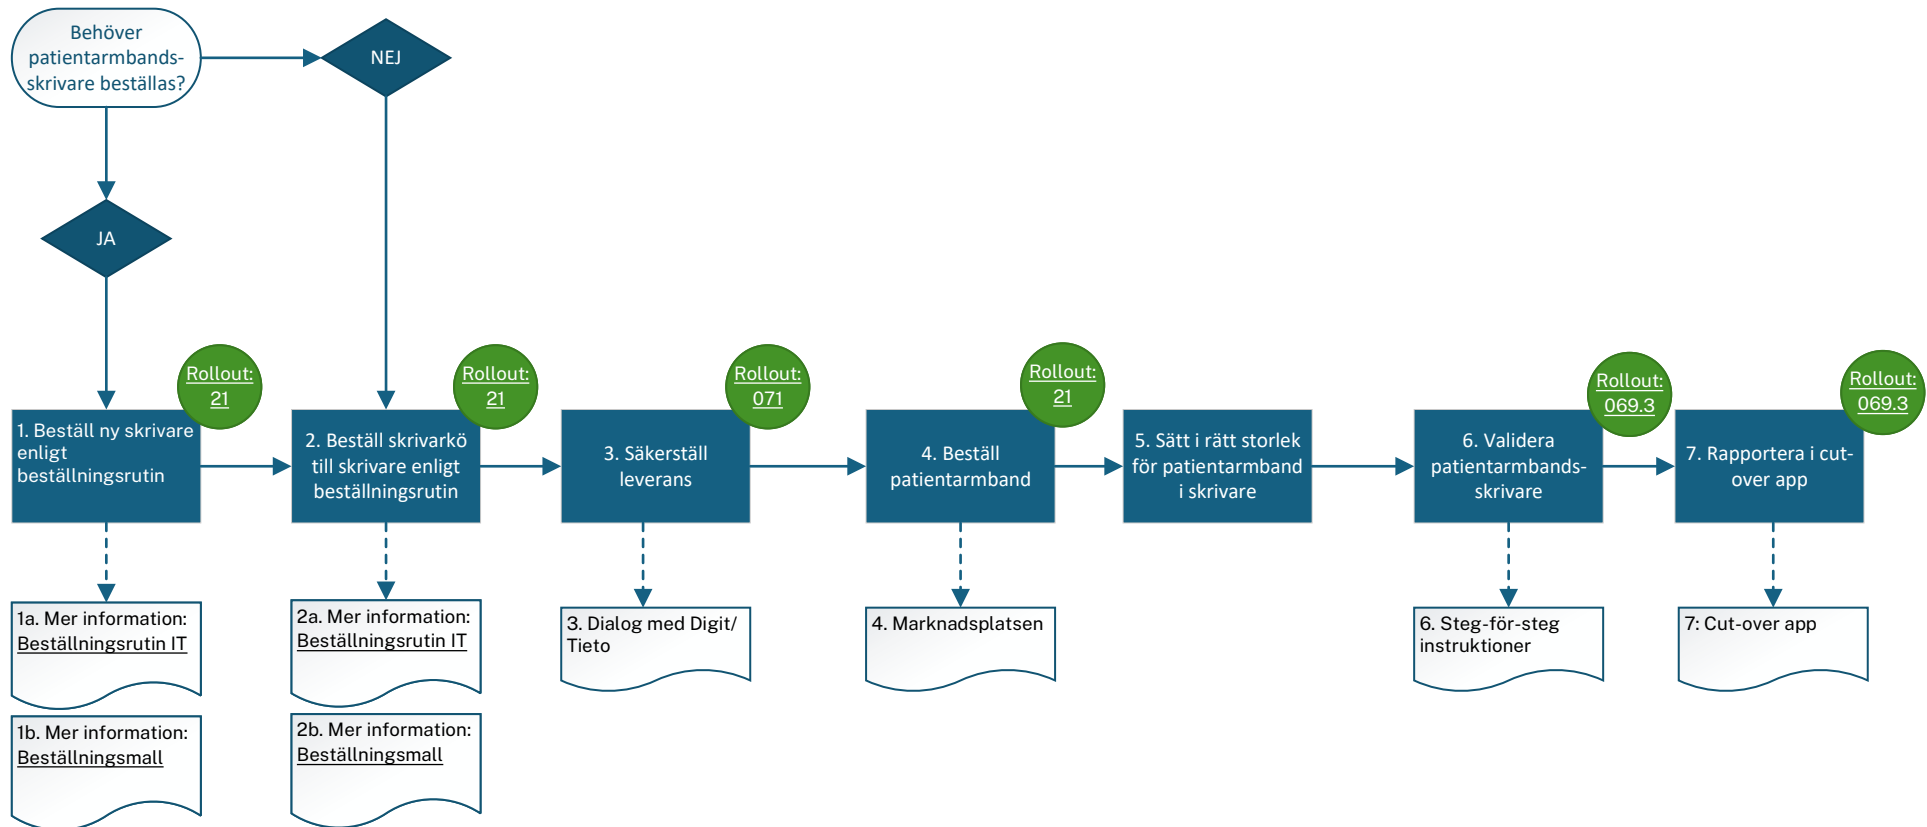


-6 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

Dokumentskrivare (A4), EJ Pullprint

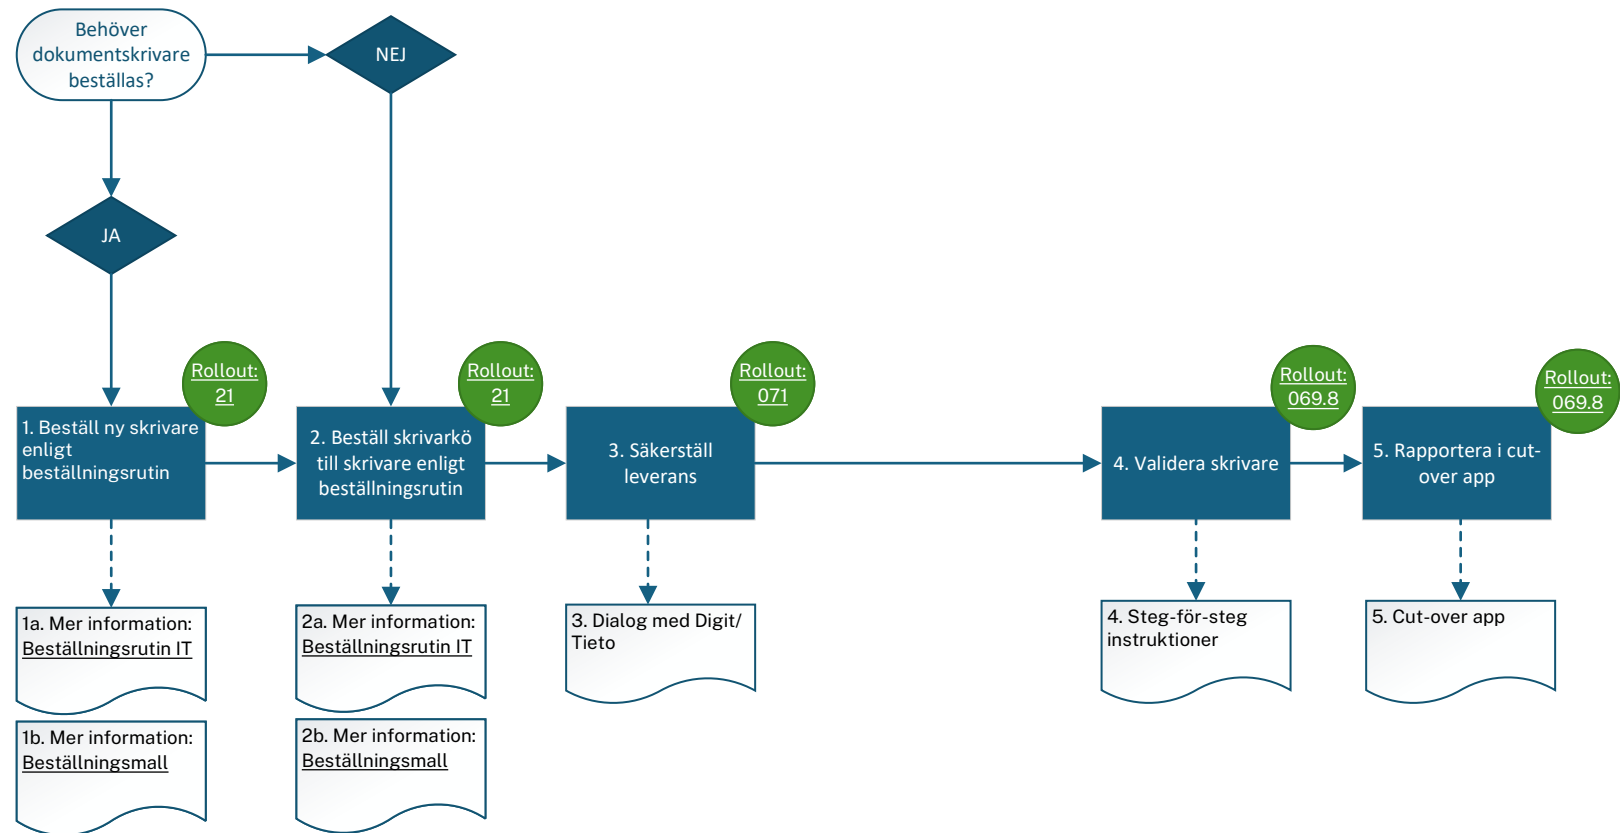


-6 månader

-5 veckor


-3 veckor

SDV
Go-Live

Kvittoskrivare

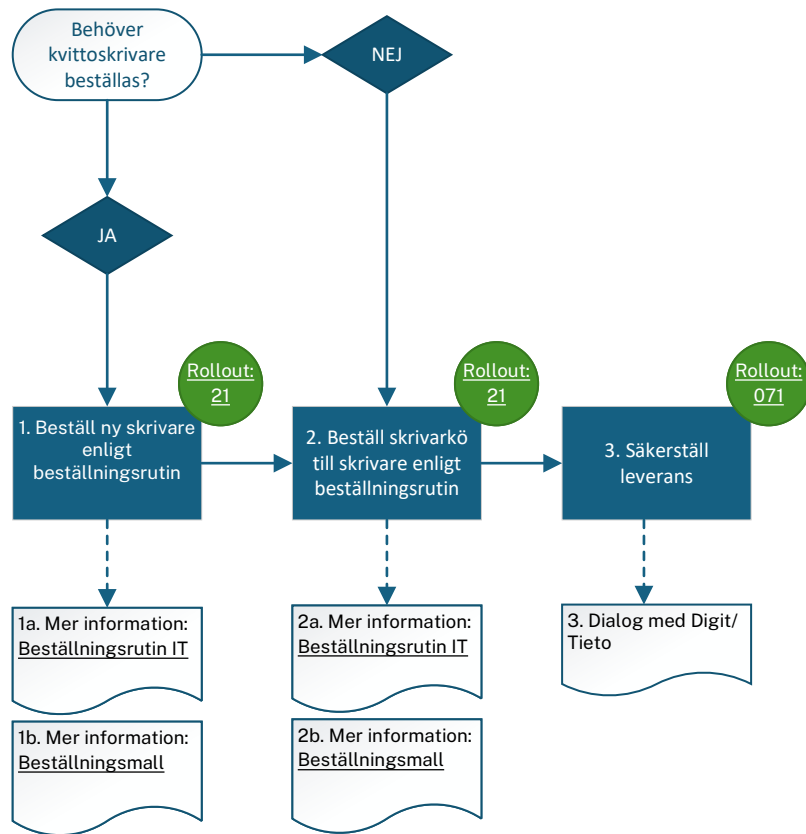

KASSAPLATS, TDB

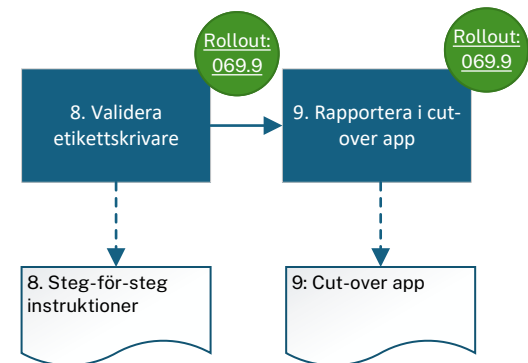


-6 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

724 DTV

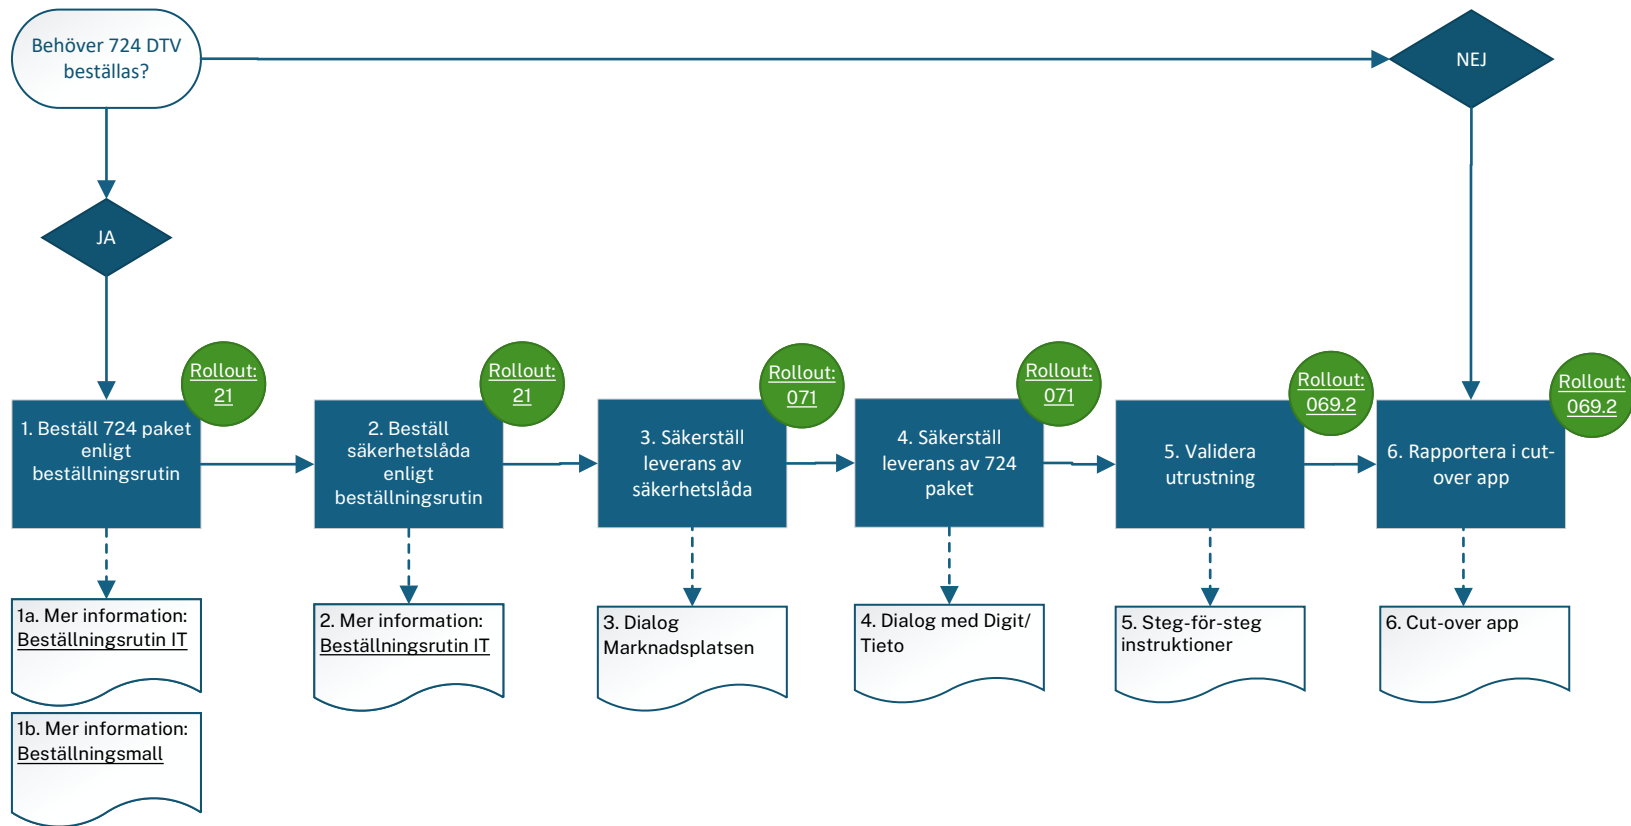


-6 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

WoW

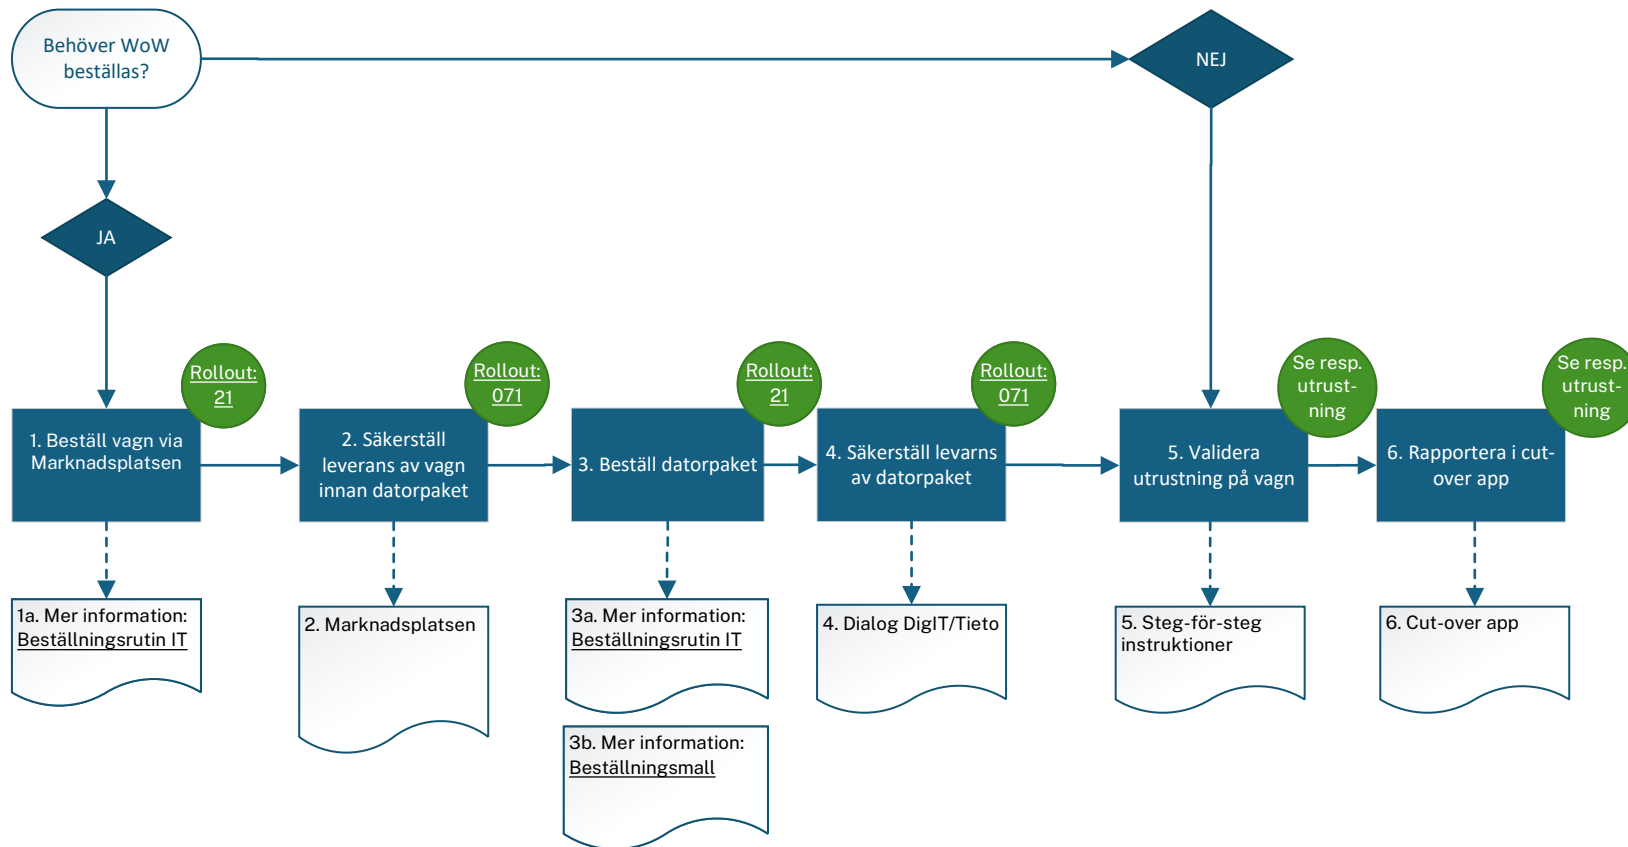


-6 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

CareView - översiktstavla

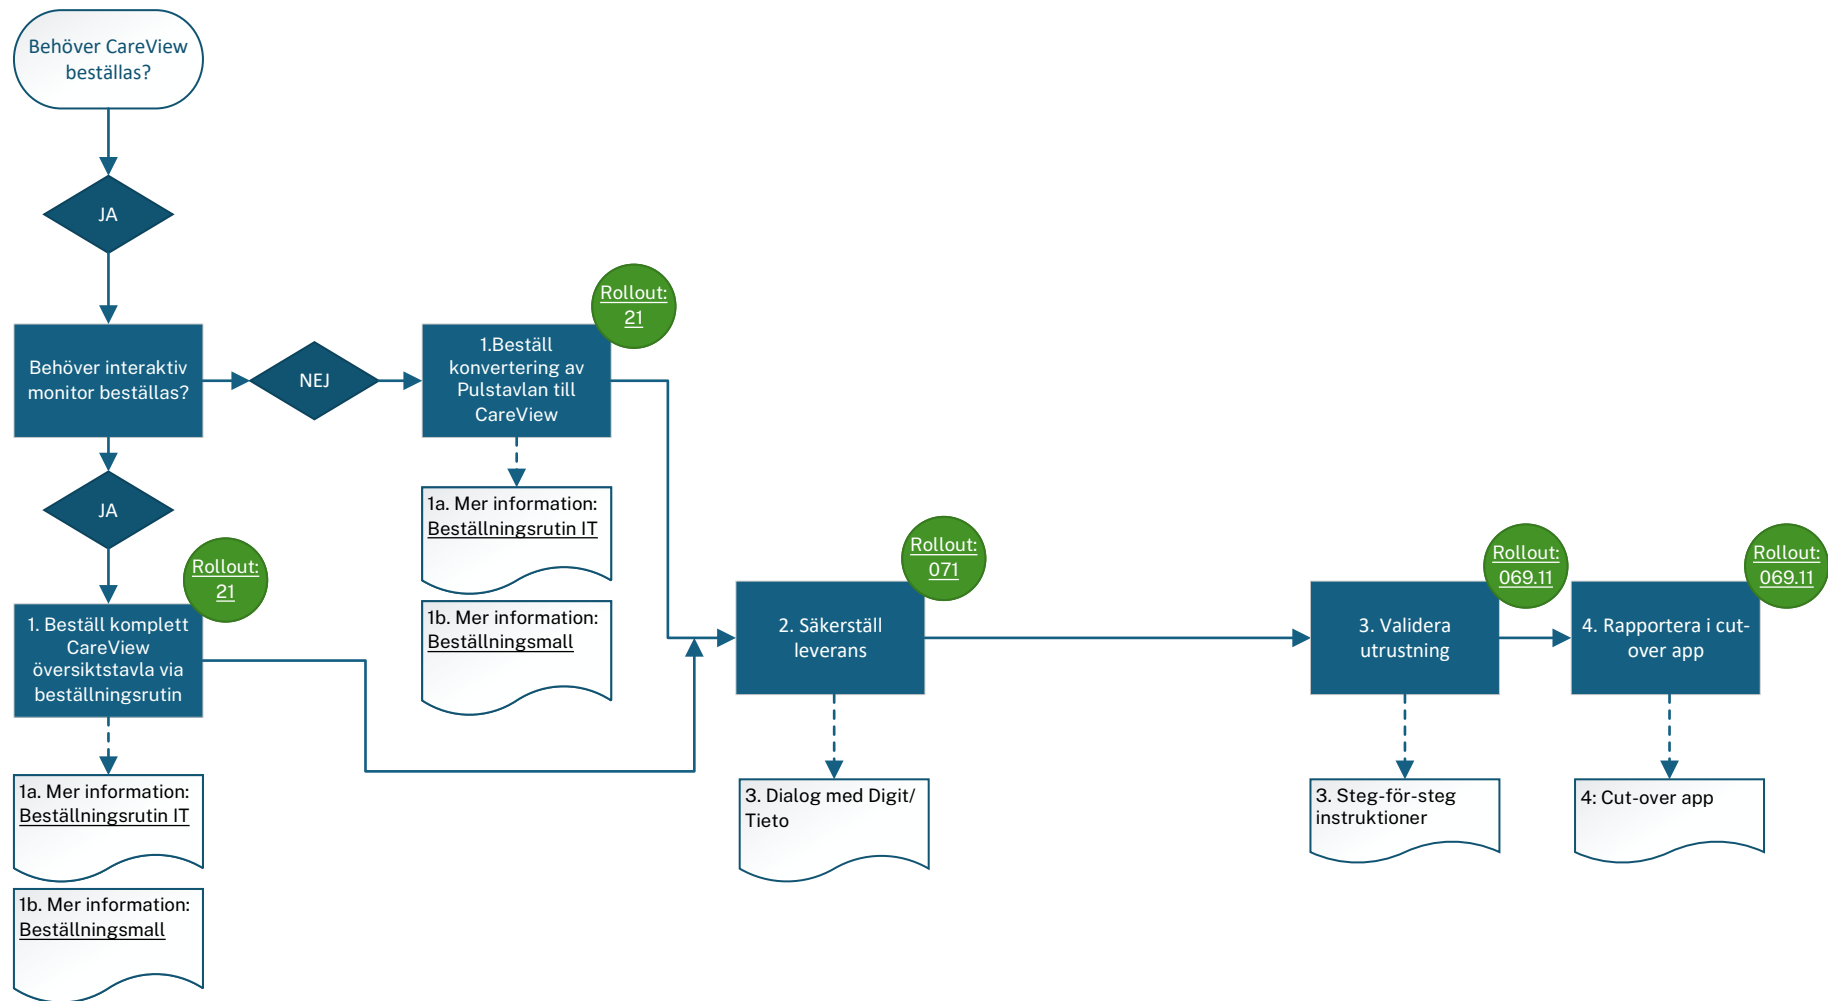


-6 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

CapMan handenhet

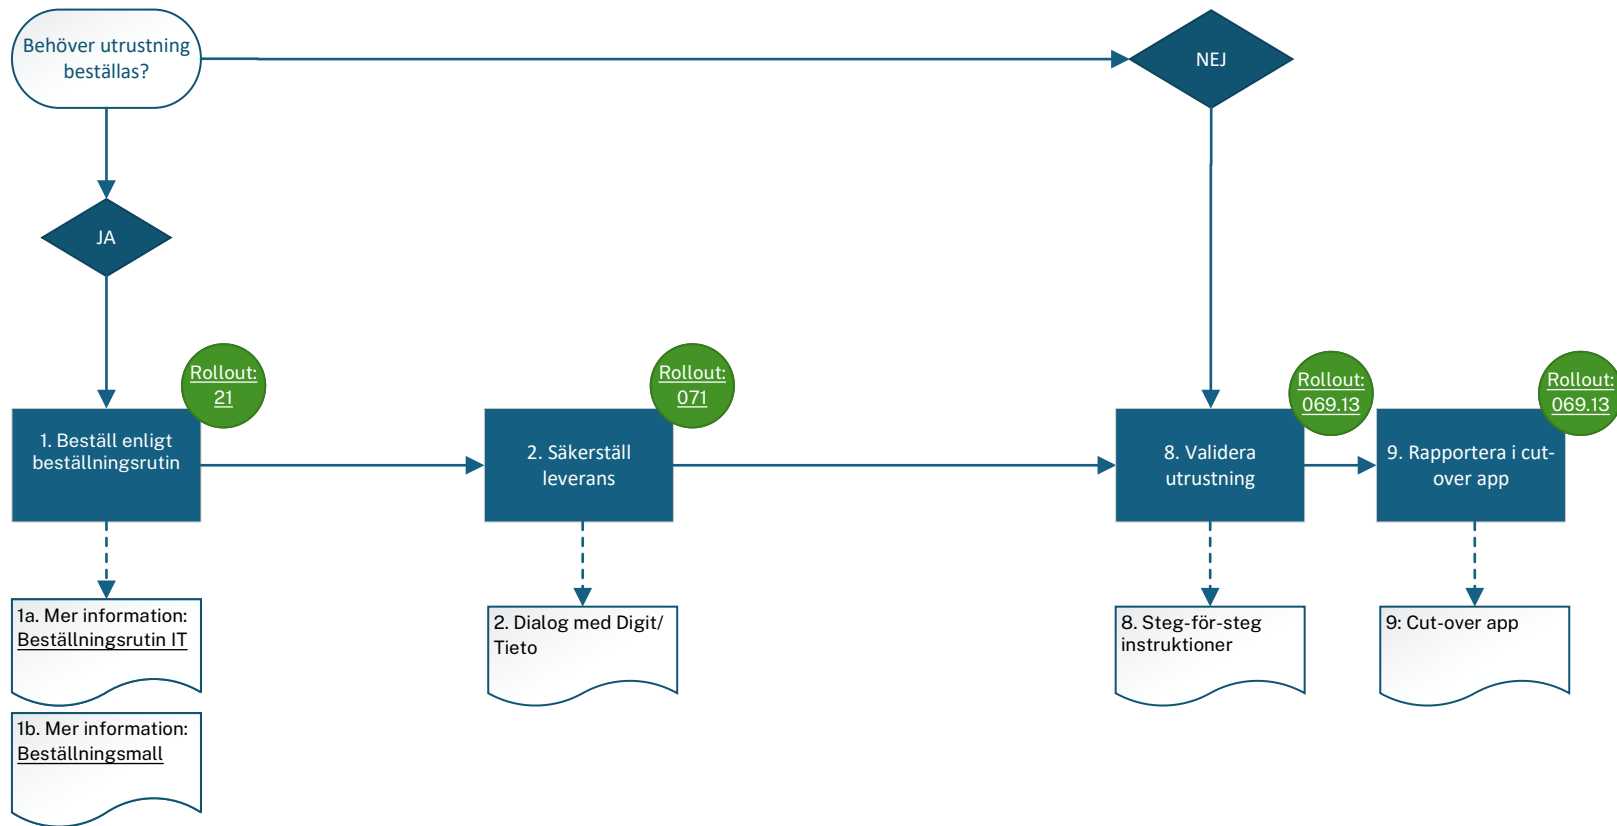


-6 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

Spotcheckmonitor

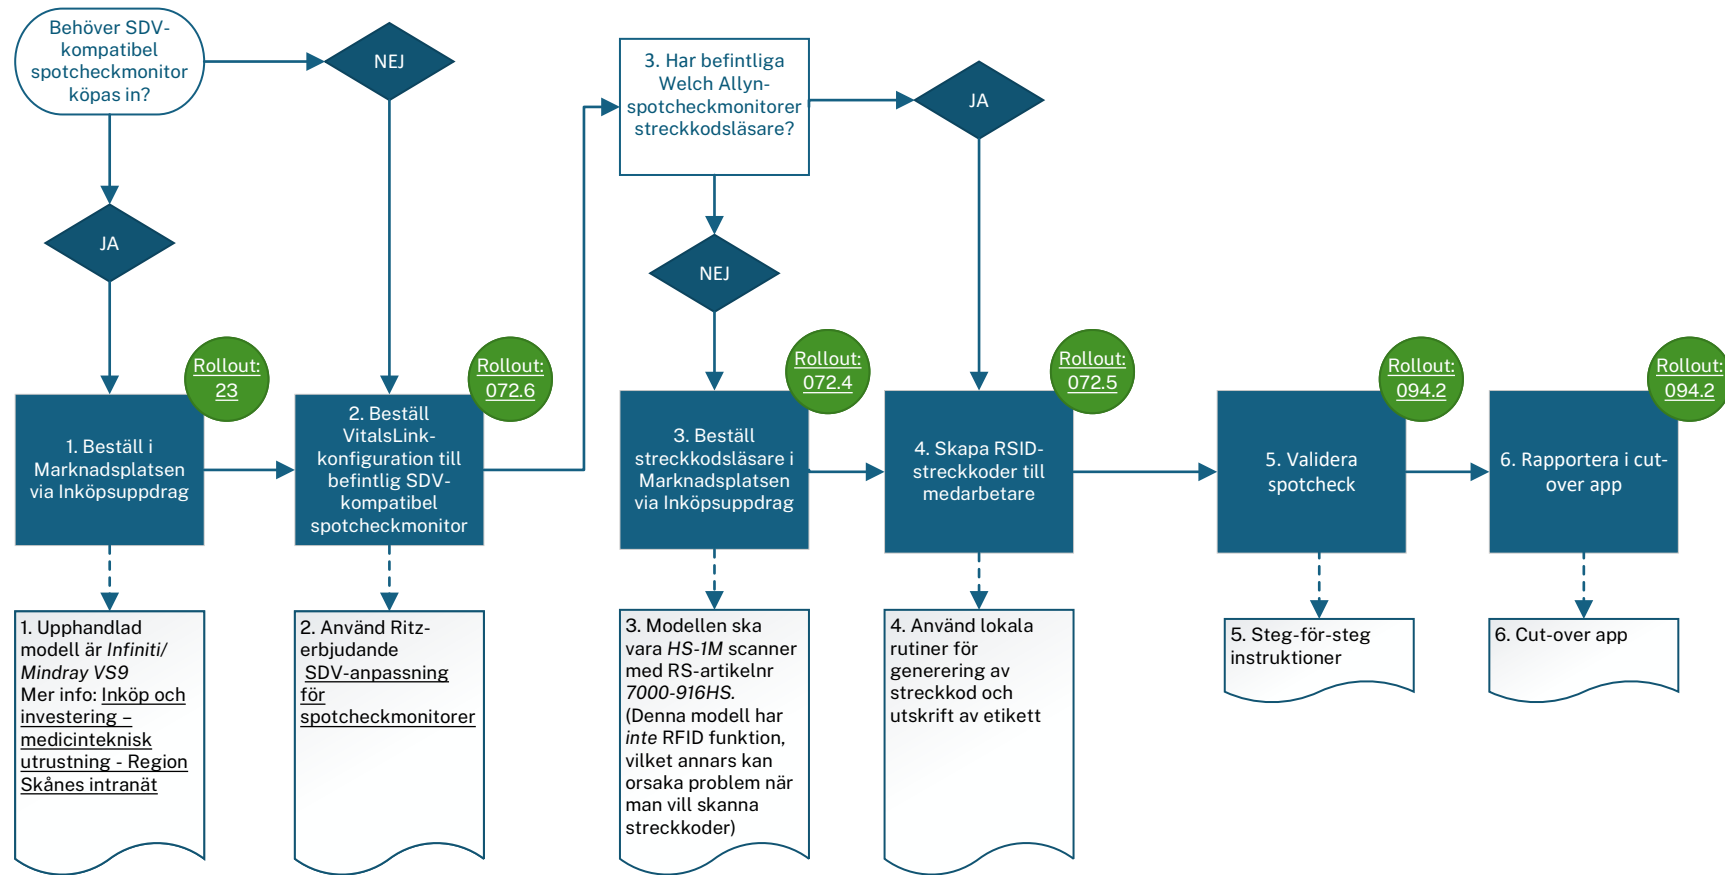

-6 månader

-4 månader


-2 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

Patientövervakning

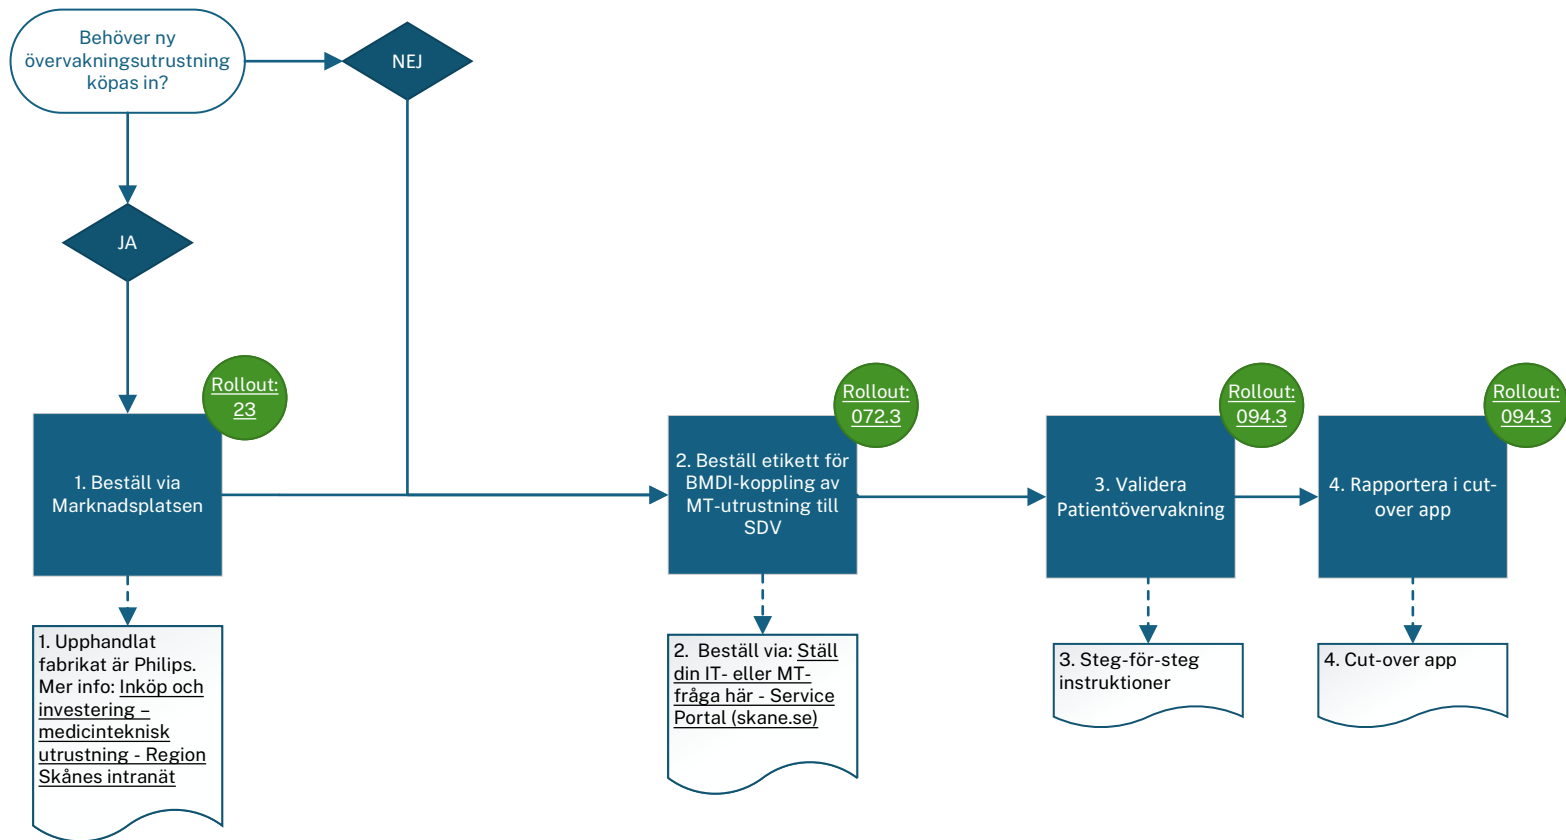

-6 månader


-2 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

Tredjepartsutrustning MT (Ventilatorer, anesthesiapparater, IVA-dialys)

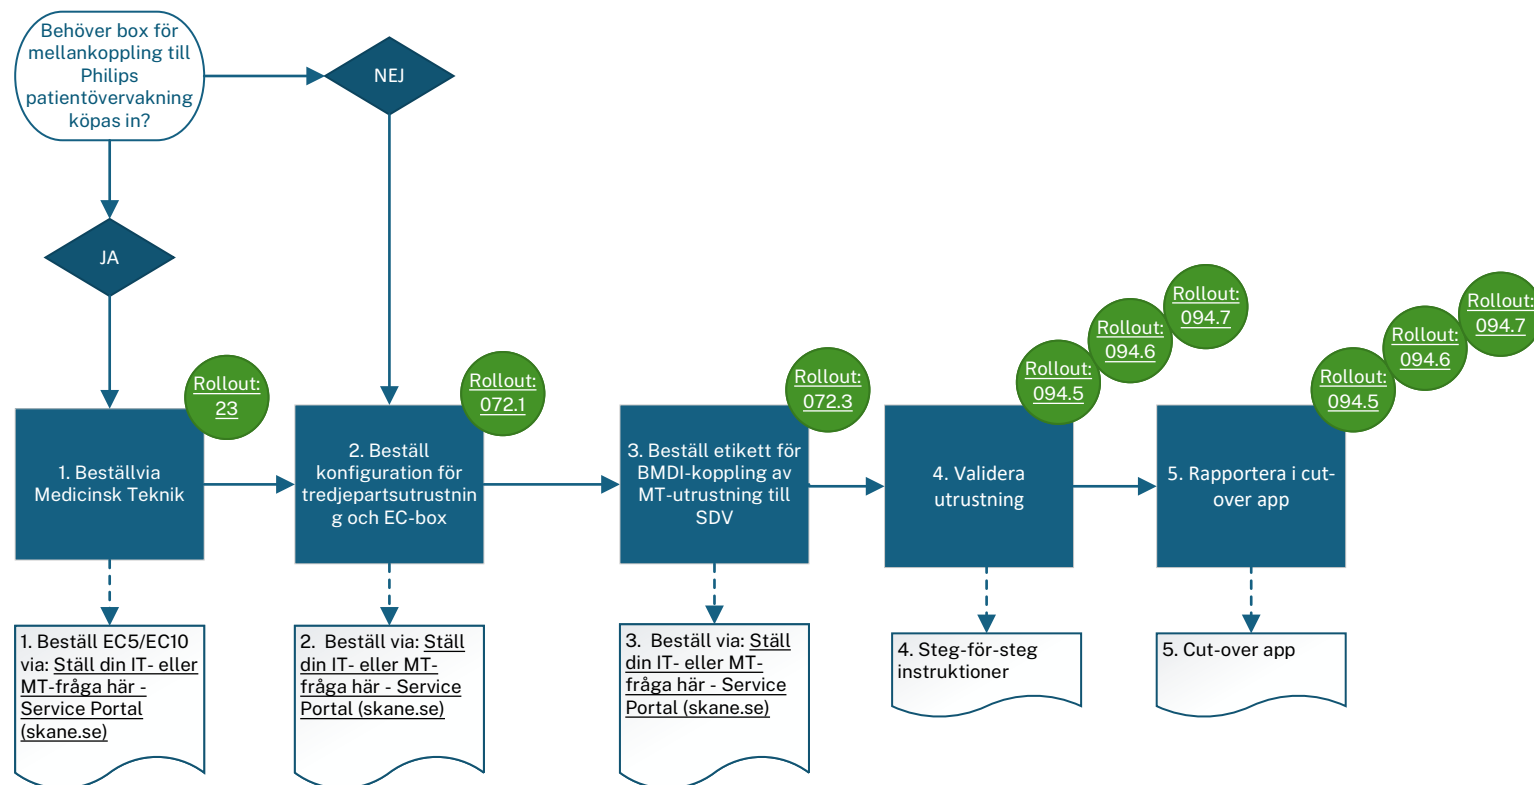

-6 månader


-2 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live

Hemodialys Artis

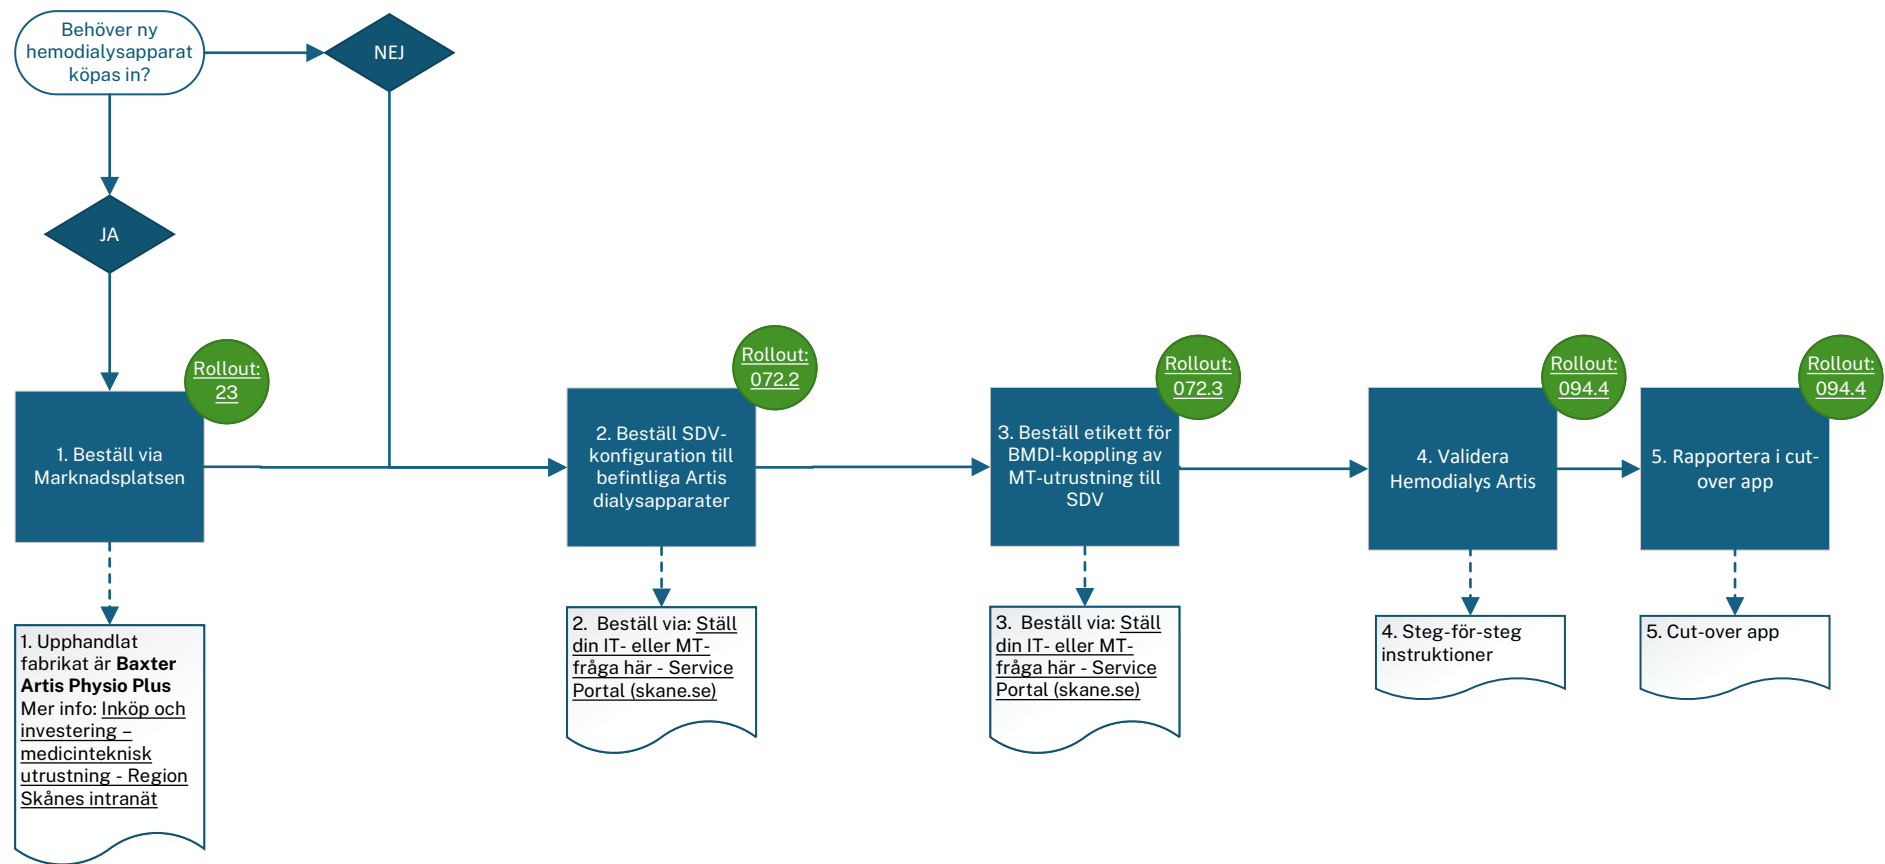

-6 månader

-2 månader

-5 veckor

-3 veckor

SDV
Go-Live